
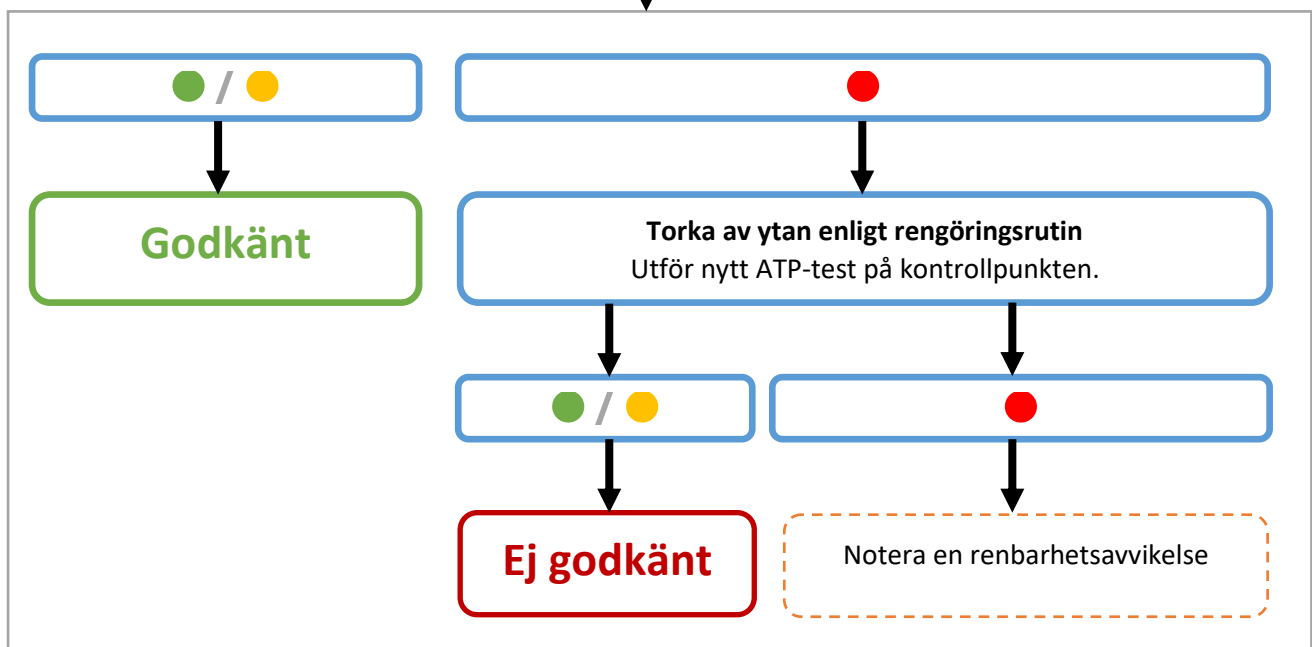


Testalgoritm för provtagning med renbarhetsverifiering. Gäller för Clean-Trace™ ATP-mätare.
ATP-gränsvärden för Hygienklass 2 eller 3, Kvalitetsnivå 5 (SS 8760014).

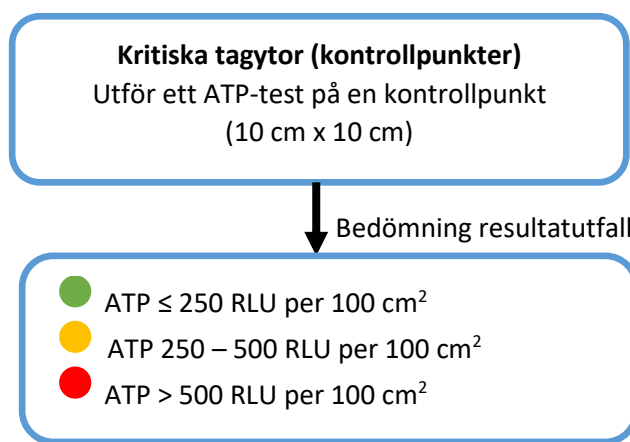

©Hygiene Diagnostics AB

Vid frågor kontakta:

Frank Axelsson, frank@hygiene-diagnostics.se